



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro de Especialidades Médicas  
Antônio Dias Dos Santos



Pregão Presencial Nº106/2023

Processo Licitatório Nº 209/2023

PRC Nº 220/23

#### **Análise das Propostas:**

**\*Fornecedor: Mhédica**

**Item 17: Foco Cirúrgico:** atende ao edital.

**\*Fornecedor: DMT**

**Todos os produtos do catálogo** atendem a proposta do edital nos diversos itens apresentados

**\*Fornecedor: Beagá Hospitalar**

**Item 5: Mesa Hospitalar Inox para instrumentação**

Faltou especificar bitola.

**Item 17: Foco Cirúrgico Móvel LED:**

12 LEDS principais e 24 LEDS verde auxiliares

Edital pede RA e R9 Mínimo de 95R

Na proposta do Fornecedor:

Índice de Reprodução de cor Ra >ou = 95. índice específico R9 (<73)

Não atende ao R 9.

Quantidade de LEDS, além de gastar mais energia, eles possuem 36 LEDS no total e com isso, são mais lâmpadas para troca caso ocorra queima de algum LED.

RA, mede a cor real da superfície, no caso o local onde será usado no paciente, quanto maior o RA, melhor a possibilidade de melhora e de ver as cores reais daquelas superfícies.

RA de 84 (abaixo do especificado), que mede os tons avermelhados, tom da pele e anexos, quanto maior o índice, melhor fica a intensidade de ver os tons avermelhados, com melhor visualização para cavidades e procedimentos.

**Item 24: Carrinho para Transporte:**

Rodízios de 3" e o exigido pelo edital é de 5"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro de Especialidades Médicas  
Antônio Dias Dos Santos



**\*Fornecedor: Nelson Alves de Moraes (NAM)**


**Proposta apresentada em conformidade**

**\*Fornecedor: DESTAK**

**Item 3: Biombo**

Material algodão cru diferente edital

**Itens: 16 Suporte para Braço** – Não especifica se o aço é AISI 304 e a altura máxima é inferior a exigida.

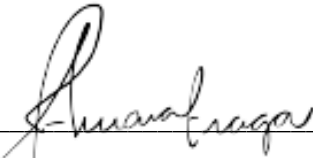

---

**Juliana Myriam Amaral Fraga**  
Coren - MG 552809  
Coordenadora de Enfermagem do CEM  
RT DE ENFERMAGEM